

สัญญาเช่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

สัญญาเลขที่ ๑ /๒๕๖๓

สัญญานี้ทำขึ้น ณ โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่.....๒๕.....๒๕๖๓..... ระหว่าง โรงพยาบาลศรีสมเด็จ โดยนายอัครารุท ใจหาญ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้เช่า" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมติคอล ดิจิตอล ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๗๑/๔๙ หมู่ ๓ ตำบล/แขวงคลองหนึ่ง อำเภอ/เขตคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยนายเกรียงไกร ฐิตะสัจจา หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด เมติคอล ดิจิตอล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๒๐๘๗๔๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ แบบทำสัญญาซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ให้เช่า" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. นิยาม

ในสัญญานี้

"ค่าเช่า" หมายความว่ารวมถึงค่าบำรุงรักษาด้วย

"ค่าบำรุงรักษา" หมายความว่ารวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข

"การบำรุงรักษา" หมายความว่ารวมถึงการซ่อมแซมแก้ไขและเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่เช่า

"การซ่อมแก้ไข" หมายความว่ารวมถึงการซ่อมแซมแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมแก้ไขเล็กน้อยหรือไม่

ข้อ ๒. ข้อตกลงเช่า

ผู้เช่าตกลงเช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิทัลระบบจัดเก็บข้อมูลภาพทางการแพทย์ Pacs พร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิทัลของทันตกรรม พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ ชุด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ฯ" (ตามรายละเอียดแนบทำสัญญา ในผนวก ๑) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๕๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ผู้เช่า
(นายอัครารุท ใจหาญ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เมติคอล ดิจิตอล
(ลงชื่อ) ผู้ให้เช่า
(นายเกรียงไกร ฐิตะสัจจา)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายศุภรัตน์ หิรัญโชติ)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายวิทยา ปิตโต)

/ข้อ ๓. เอกสาร...

ข้อ ๓.เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๓.๑) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๖ หน้า

๓.๒) รายการหรือแคตตาล็อกฯ จำนวน ๑๖ หน้า

๓.๓) ใบเสนอราคา จำนวน ๑ หน้า

๓.๔) หนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน ๗ หน้า

๓.๕) อื่นๆ จำนวน ๒ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้เช่า คำวินิจฉัยของผู้เช่าให้ถือเป็นที่สุด และผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้เช่าทั้งสิ้น

ข้อ ๔.ระยะเวลาการเช่า

ระยะเวลาในการเช่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ฯตามสัญญานี้ให้มีกำหนด ๗ เดือน สัญญานี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา

ข้อ ๕.การชำระค่าเช่า

การเช่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ฯตามสัญญานี้ เป็นการเช่าแบบมีกำหนดระยะเวลา โดยผู้เช่าจะชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามเดือนแห่งปฏิทิน ในอัตราค่าเช่าเดือนละ ๓๕,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นระยะเวลา ๗ เดือน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๔๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ข้อ ๖.การรับรองคุณภาพ

ผู้ให้เช่ารับรองว่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ฯที่ให้เช่าตามสัญญานี้ มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ตามผนวก ๑

ข้อ ๗.การส่งมอบและติดตั้ง

ผู้ให้เช่าจะทำการขนส่งและติดตั้งครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ฯที่เช่าตามสัญญานี้ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒ แห่งสัญญานี้ในลักษณะพร้อมที่จะใช้งานได้ ตามรายละเอียดการทดสอบแนบท้ายสัญญาให้แก่ผู้เช่า ณ โรงพยาบาลศรีสมเด็จ เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด และส่งมอบให้แก่ผู้เช่าภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาได้ลงนามในสัญญา ซึ่งผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ประกอบ พร้อมทั้งเครื่องมือที่จำเป็นในการติดตั้ง โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

(ลงชื่อ) ผู้เช่า
(นายอัครารุจ ใจหาญ)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายศรุตน์ หิรัญโชติ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ให้เช่า
(ลงชื่อ)
เมตติคอล ดิจิตอล (นายเกรียงไกร จิตะสังจา)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายวิทยา ปิตโต)

/ผู้ให้เช่า...

ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งกำหนดเวลาติดตั้งแล้วเสร็จ พร้อมทั้งจะใช้งานและออกแบบสถานที่ติดตั้งครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ฯ รวมทั้งระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานของผู้ให้เช่าซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้เช่าแล้วและผู้ให้เช่าต้องจัดหาเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของสถานที่ให้ทันต่อการติดตั้งเครื่อง และส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาฯ ทั้งนี้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจากผู้เช่า

ข้อ ๘.การตรวจรับ

เมื่อผู้เช่าได้ตรวจรับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ฯ ที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาฯ แล้ว ผู้เช่าจะออกหลักฐานการรับมอบ ไว้เป็นหนังสือเพื่อผู้ให้เช่านำมาใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการขอรับเงินค่าเช่าแต่ละรายเดือนนั้น

ถ้าผลการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ให้เช่าส่งมอบให้ผู้เช่าไม่ตรงตามสัญญาข้อ ๒ ผู้เช่าจะทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ให้เช่าต้องรีบนำส่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาให้ใหม่หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองและระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ให้เช่าจะนำมาอ้างอิงเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๙.การบำรุงรักษา

ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ให้การบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ฯ ที่ให้เช่าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าโดยต้องจัดหาช่างผู้มีความรู้ความชำนาญ และมีฝีมือมาตรวจสอบบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ฯ ที่ให้เช่าตลอดอายุสัญญาเช่านี้ อย่างน้อย ๑ ครั้ง ในระยะเวลา ๓ เดือน

ข้อ ๑๐.การซ่อมแซมแก้ไข

ในกรณีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ฯ ที่ให้เช่าชำรุดบกพร่องใช้งานไม่ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยมิใช่ความผิดของผู้เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องจัดให้ช่างที่มีความรู้ ความชำนาญและมีฝีมือมาจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ตามปกติ

ข้อ ๑๑.การใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ในครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ฯ ที่ให้เช่าตามสัญญาฯ ผู้ให้เช่ายินยอมให้อยู่ภายใต้การจัดการและการควบคุมดูแลของผู้เช่าโดยสิ้นเชิง นอกจากผู้เช่าจะใช้ในการปฏิบัติงานของผู้เช่าแล้ว ผู้เช่าอาจให้ผู้อื่นมาใช้เครื่องนี้ได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เช่า

(ลงชื่อ) ผู้เช่า
(นายอัครารุช ใจหาญ)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายศุภรัตน์ หิรัญโชติ)

..... ผู้ให้เช่า
(ลงชื่อ)
เมดิคอล ดิจิตอล (นายเกรียงไกร รุติะสังจา)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายวิทยา ปิตโต)

/ข้อ ๑๒.การจัด...

ข้อ ๑๒.การจัดอบรม

ผู้ให้เช่าต้องจัดอบรมและแนะนำวิธีการใช้งาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ของผู้เช่า ก่อนการติดตั้งและให้แล้วเสร็จก่อนพ้นจากข้อผูกพัน ตามสัญญาข้อ ๔ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

ข้อ ๑๓. คู่มือการใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ผู้ให้เช่าต้องจัดหาคู่มือการใช้งานเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดังกล่าว ที่ให้เช่าตามสัญญานี้ พร้อมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย ตลอดอายุสัญญานี้ ให้กับผู้เช่าโดยไม่คิดมูลค่า นับแต่วันส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ข้อ ๑๔.หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้ให้เช่าได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๒๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของค่าเช่าครุภัณฑ์ทั้งหมดตามสัญญา มามอบไว้แก่ผู้เช่าเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ให้เช่าใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ให้เช่าพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่นำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้ให้เช่า ตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ให้เช่านำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ให้เช่าตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ให้เช่า ส่งมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ผู้ให้เช่าต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตาม วรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้เช่าภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่า

หลักประกันที่ผู้ให้เช่านำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้เช่าจะคืนให้แก่ผู้ให้เช่า โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้ให้เช่าพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

(ลงชื่อ) ผู้เช่า
(นายอัศราวุธ ใจหาญ)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายศุภรัตน์ หิรัญโชติ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ให้เช่า
เมดิคอล ดิจิตอล (นพ.เกรียงไกร ฐิตะสังจา)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายวิทยา ปิตโต)

/ข้อ ๑๕.การรับ...

ข้อ ๑๕. การรับประกันความเสียหาย

ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้าง หรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรเกี่ยวกับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ฯ ตามสัญญาฯ โดยผู้เช่ามิได้แก้ไขตัดแปลงไปจากเดิม ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการทั้งปวง เพื่อให้การกล่าวอ้าง หรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้ให้เช่าอาจกระทำได้ และผู้เช่าต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรดังกล่าว ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้เช่า ทั้งนี้ ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร ในเมื่อได้มีการกล่าวอ้าง หรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

ข้อ ๑๖. ความรับผิดชอบความเสียหาย

ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแก่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อันไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าตลอดระยะเวลาที่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อยู่ในความครอบครองของผู้เช่า

ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นแก่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่อยู่ใน ความครอบครองของผู้เช่าตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่าต้องดำเนินการทุกประการตามที่จำเป็นเพื่อให้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ กลับคืนสภาพที่ใช้งานได้ดังเดิมโดยเร็วที่สุด และในกรณีที่ไมอาจดำเนินการให้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์คืนสู่สภาพ ที่ใช้งานได้ดังเดิมได้ หรือในกรณีที่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์สูญหาย ผู้ให้เช่าต้องนำครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องใหม่ที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ และความสามารถใช้งานไม่ต่ำกว่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์มาติดตั้งให้แก่ผู้เช่าแทนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่า ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่นำมาติดตั้งแทนนี้ให้ถือเป็นครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ตามนัยข้อ ๒ แห่งสัญญาฯ ด้วย ทั้งนี้ ในการปฏิบัติตามสัญญาข้อนี้ผู้ให้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ข้อ ๑๗. การบอกเลิกสัญญา

เมื่อครบกำหนดติดตั้งและส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ตามสัญญาแล้ว ถ้าผู้ให้เช่าไม่ส่งมอบ และติดตั้งครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์บางรายการหรือทั้งหมดให้แก่ผู้เช่าภายในกำหนดเวลาตามสัญญา หรือส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ไม่ตรงตามสัญญา หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามสัญญา หรือส่งมอบและติดตั้งแล้วเสร็จภายในกำหนด แต่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้งานได้ไม่ครบถ้วนตามสัญญา หรือผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้เช่าที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ให้เช่า

(ลงชื่อ) ผู้เช่า
(นายอัครราช ใจหาญ)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายศรุตน์ หิรัญโชติ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เมดิคอล ซีทีเอส
(นายเกรียงไกร ฐิตะสังจา) ผู้ให้เช่า

(ลงชื่อ) พยาน
(นายวิทยา ปิตโต)

ในกรณีที่ผู้เช่า...

ในกรณีที่ผู้เช่าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้เช่ามีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๑๔ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้แล้วแต่ผู้เช่าจะเห็นสมควร และถ้าผู้เช่าต้องเช่าครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์จากบุคคลอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนภายในกำหนด ๑ เดือน นับถัดจากวันบอก เลิกสัญญา ผู้ให้เช่าย่อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากค่าเช่าที่กำหนดไว้ในสัญญานี้รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้ เช่าต้องใช้จ่ายในการจัดหาผู้ให้เช่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์รายใหม่ดังกล่าวด้วย

ข้อ ๑๘. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๗ ผู้ให้เช่าจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้เช่าเป็น รายวันสำหรับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ในอัตราวัน ละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ต่อเครื่อง นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ให้เช่าได้นำ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์มาส่งมอบและติดตั้งให้แก่ผู้เช่าจนถูกต้องครบถ้วน

การคิดค่าปรับในครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่ตกลงเช่าเป็นระบบ ถ้าผู้ให้เช่าส่งมอบ เพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป หรือส่งมอบและติดตั้งทั้งหมดแล้วแต่มีคุณสมบัติไม่ ครบถ้วนหรือใช้งานไม่ได้โดยไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ถูกต้องครบถ้วนให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์นั้นเลย และให้คิดค่าปรับเป็นรายวันจากราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ทั้งระบบ

ในระหว่างที่ผู้เช่ายังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ถ้าผู้เช่าเห็นว่าผู้ให้เช่าไม่อาจปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้เช่าจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และรับหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๑๔ กับเรียกร้องให้ ชดใช้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๗ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้เช่าได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไป ยังผู้ให้เช่า เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้วผู้เช่ามีสิทธิที่จะปรับผู้ให้เช่าจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๙. การนำเครื่องกลับคืนไป

เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าจะโดยการบอกเลิกสัญญา หรือครบอายุสัญญา ผู้ให้เช่าต้องนำคอมพิวเตอร์ กลับคืนไปภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ถ้าผู้ให้เช่าไม่นำครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์กลับคืนไปภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ เช่าจะกำหนดเวลาให้ผู้ให้เช่านำครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์กลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพ้น กำหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้ให้เช่ายังไม่นำครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์กลับคืนไปอีก ผู้เช่ามีสิทธินำ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ขายทอดตลาดได้ทันที โดยเงินที่ได้จากการออกขายทอดตลาด ผู้ให้เช่าตก ลงยินยอมให้ผู้เช่าหักเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่าย ที่ผู้เช่าได้เสียไปในการ ดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการทำสถานที่ที่รื้อถอน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ออกไปให้มีสภาพดังที่เป็นอยู่เดิมก่อนทำสัญญานี้ เงินที่เหลือจากการหัก ค่าปรับ ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายแล้ว ผู้เช่าจะคืนให้แก่ผู้ให้เช่าแต่หากขายทอดตลาดไม่ได้หรือขายได้แต่ได้ เงินไม่เพียงพอที่จะชดใช้เป็นค่าปรับ ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายดังกล่าว ผู้ให้เช่ายังคงต้องรับผิดชอบชดใช้ให้แก่ ผู้เช่าจนครบถ้วน

(ลงชื่อ) ผู้เช่า
(นายอัครารุ ใจหาญ)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายศรุตน์ หิรัญโชติ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ให้เช่า
เมติคอล ดิจิทัลเรียลไทม์ วิเคราะห์
(ลงชื่อ) ผู้ให้เช่า

(ลงชื่อ) พยาน
(นายวิทยา ปิตโต)

/เมื่อสัญญา...

เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นอันเกิด แก่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้เช่า

ข้อ ๒๐. การโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่น

ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าจะไม่โอนกรรมสิทธิ์ในเครื่องที่ให้เช่าแก่บุคคลอื่น หากผู้ให้เช่าฝ่าฝืน ผู้ให้เช่ายินยอมชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่า

ข้อ ๒๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้เช่า ผู้ให้เช่าต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้แก่ผู้เช่าโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ จากผู้เช่า หากผู้ให้เช่าไม่ชดเชยให้ ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้เช่ามีสิทธิที่จะหักเอาจาก ค่าเช่าที่ต้องชำระ หรือบังคับจาก หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากค่าเช่าที่ต้องชำระ หรือหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ให้เช่ายินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้เช่า

ข้อ ๒๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้เช่า หรือจากเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งที่ผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ให้เช่าไม่สามารถส่งมอบ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาในข้อ ๗ แห่งสัญญานี้ได้ หรือไม่สามารถซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์หรือจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ให้ ผู้เช่าใช้แทนตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาในข้อ ๑๐ ได้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ให้เช่าได้ละสิทธิเรียกร้อง ใน การที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำการตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิด จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้เช่าซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้เช่าทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้เช่าที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ) ผู้เช่า
(นายอัครราช ใจหาญ)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายศรุตน์ หิรัญโชติ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ให้เช่า
(ลงชื่อ)
เมดิคอล ดิจิตอล (นายเกรียงไกร ฐิตะสังจา)


(ลงชื่อ) พยาน
(นายวิทยา ปิตโต)

/ข้อ ๒๓. การโอน...

ข้อ ๒๓ การโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา

ผู้ให้เช่าจะไม่โอนสิทธิและหน้าที่ที่มีต่อผู้เช่าตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้เช่าก่อน

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)		ผู้เช่า	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมติคอล ดิจิตอล	(ลงชื่อ)		ผู้ให้เช่า
	(นายอัสราวุธ ใจหาญ)					(นายเกรียงไกร ชูตะสังจา)
(ลงชื่อ)		พยาน		(ลงชื่อ)		พยาน
	(นายศรุตน์ หิรัญโชติ)				(นายวิทยา ปีโต)	

คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล (CR) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งรูปภาพทางการแพทย์ (PACS) และเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัลทางทันตกรรม พร้อมอุปกรณ์

1. คุณลักษณะทั่วไปประกอบด้วย

- 1.1 โปรแกรมจัดเก็บและรับส่งรูปภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 ชุด
- 1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง
- 1.3 เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล (Computed Radiography) จำนวน 1 ชุด
- 1.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานของเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด
- 1.5 เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณข้อมูลภาพเอกซเรย์ทางทันตกรรม จำนวน 1 ชุด
- 1.6 เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานของเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ทางทันตกรรม จำนวน 1 ชุด
- 1.7 โปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ทางทันตกรรม จำนวน 1 ชุด
- 1.8 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับแสดงผลภาพเอกซเรย์ จำนวน 1 ชุด

2. คุณลักษณะทางเทคนิค

- 2.1 โปรแกรมจัดเก็บและรับส่งรูปภาพทางการแพทย์ (PACS) มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1.1 สามารถรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ในรูปแบบดิจิทัลโดยการรับส่งภาพข้อมูลตามมาตรฐาน DICOM 3 ผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการให้บริการตามมาตรฐานดังนี้ได้เป็นอย่างดี DICOM Store, DICOM Modality Worklist, DICOM Query / Retrieve, DICOM Print
 - 2.1.2 รองรับการใช้งานข้อมูลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 - 2.1.3 สามารถควบคุมการใช้งานระบบด้วยการ Log on ผ่านทาง Username และ Password โดยเครื่องมือ Administrator Tools
 - 2.1.4 สามารถรองรับภาพตามมาตรฐาน DICOM 3 จากอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ได้เช่น DR, CR, CT, EKG, Ultrasound, Mammography, MRI ได้เป็นอย่างดี
 - 2.1.5 รองรับการนำเข้าข้อมูลผู้ป่วยจากระบบ HIS ผ่านทางการเชื่อมต่อแบบ Database Connection และ Data File เพื่อนำข้อมูลมาให้บริการ Modality Worklist แก่อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องการได้
 - 2.1.6 สามารถกำหนดการสำรองข้อมูลภาพทางการแพทย์ไปยังอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเพื่อใช้สำรองข้อมูลได้เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน HACCP
 - 2.1.7 รองรับการเปิดภาพและการทำงานผ่าน Web Application และ Microsoft Windows Application เพื่อรองรับการทำงานได้หลากหลาย Platform
 - 2.1.8 ระบบโปรแกรมติดตั้งในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server
 - 2.1.9 มีระบบแจ้งเตือนจำนวนความจุของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภาพทางการแพทย์และสามารถกำหนดค่าการแจ้งเตือนตามความจุที่เหลือของพื้นที่จัดเก็บได้
- (ลงชื่อ)  ผู้ชื่อ
- (นายอัคราฐ ใจหาญ)
- (ลงชื่อ)  พยาน
- (นายศุภรัตน์ ทรัพย์โชติ)
- เมดิคอล ดิจิตอล
- (ลงชื่อ)  พยาน
- (นายวิทยา ปิตรี)

2.2 โปรแกรมแสดงผลภาพทางการแพทย์ (PACS Viewer) มีคุณสมบัติดังนี้

2.2.1 รองรับการแสดงผลภาพทางการแพทย์รูปแบบ DICOM, Jpeg, BMP

2.2.2 สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS Server) เพื่อรับภาพและแสดงผลภาพผ่านทางการสื่อสารระหว่างระบบโปรแกรมโดยมิใช่การแชร์ไฟล์ผ่านทางระบบเครือข่าย และมีระบบการเข้าถึงข้อมูลด้วยระบบ Username Password เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลผู้ป่วย

2.2.3 โปรแกรมมีเครื่องมือในการช่วยวินิจฉัยโรคเช่น ตรวจสอบขนาด, ตรวจสอบพื้นที่, ตรวจสอบมุม, Contract, Brightness

2.2.4 โปรแกรมสามารถทำการย่อ, ขยายภาพทางการแพทย์ได้

2.2.5 โปรแกรมสามารถหมุนภาพ Rotate Image ได้

2.2.6 โปรแกรมสามารถสั่งพิมพ์ภาพทางการแพทย์ไปยังเครื่องพิมพ์ฟิล์ม (Dry Film Print) ได้

2.2.7 โปรแกรมสามารถสั่งพิมพ์ภาพทางการแพทย์ไปยังเครื่องพิมพ์กระดาษได้

2.2.8 โปรแกรมสามารถแสดงภาพของผู้ป่วยได้หลายภาพในหน้าจอเดียวกันโดยไม่ต้องเปิดโปรแกรมใหม่เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบประวัติการรักษาและสามารถกำหนด Layout ของการแสดงผลภาพต่อได้

2.2.9 โปรแกรมสามารถบันทึกผลการวินิจฉัยและสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ได้

2.2.10 โปรแกรมสามารถบันทึกภาพทางการแพทย์ลงแผ่น CD/DVD ได้และพร้อมด้วยโปรแกรมเปิดภาพจากแผ่น CD/DVD

2.2.11 มีบันทึกการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้โดยการบันทึกจะแยกตาม Username ที่ใช้ Log on

2.2.12 โปรแกรมสามารถบันทึกภาพที่แสดงผลอยู่ให้เป็นไฟล์ชนิด DICOM และ Jpeg ได้

2.2.13 โปรแกรมสามารถแสดงผลภาพทางการแพทย์ประเภท CT, MRI และทำแสดงผลภาพแบบ CINE ได้

2.2.14 โปรแกรมสามารถค้นหาข้อมูลผู้ป่วยได้ตามการคัดกรองข้อมูล เช่น วันที่, ชื่อ-นามสกุล, HN, Modality ได้

2.2.15 โปรแกรมสามารถทำงานได้กับ Microsoft Windows XP เป็นอย่างน้อย

2.2.16 โปรแกรมสามารถทำงานได้บนคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำ (RAM) 512 MB. เป็นอย่างน้อย

2.2.17 โปรแกรมสามารถทำ Presentation ได้เพื่อใช้บ่งชี้ตำแหน่งของโรคและสามารถปิดเปิดการแสดง Presentation ได้

2.2.18 โปรแกรมรองรับการส่งภาพทางการแพทย์ไปยังแม่ข่ายระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์ได้(DICOM Send)

2.2.19 สามารถบันทึกค่ามาตรฐานของค่า Contract, Brightness ได้ตามลักษณะการใช้งานของผู้ใช้นั้น

2.2.20 สามารถเปิดภาพทางการแพทย์จากผู้ใช้งานหลายๆ คนได้โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน

2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

2.3.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง Intel Xeon Quad Core และมีความเร็วในการประมวลไม่น้อยกว่า 3.1 GHz. ไม่น้อยกว่า 1 หน่วย หรือดีกว่า

2.3.2 หน่วยจัดเก็บข้อมูล รองรับการทำงานแบบ Raid 0, 1, 10 (Hard disk) เป็นแบบ SATA หรือดีกว่า มีความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 2 หน่วย

2.3.3 มีหน่วยความจำ (RAM) ชนิด DDR3 ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB หรือดีกว่า

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(นายอัคราฐ ใจหาญ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นายศุภรัตน์ หิรัญโชติ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เมตคอลลเจ็คตอล

(ลงชื่อ)

(นายวิภา ปิตโต)

- 2.3.4 มีการ์ระบบเครือข่ายรองรับความเร็วในการเชื่อมต่อ 10/100/1000 Mbps
- 2.3.5 มีระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 เทียบเท่าหรือดีกว่าที่เป็นลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
- 2.3.6 มี DVD-RW
- 2.3.7 เครื่องสำรองไฟขนาด 900VA.

3. เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นดิจิทัล (Computed Radiography) จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

- 3.1 สามารถให้อ่านภาพเอกซเรย์จากแผ่นบันทึกภาพ (Screen) ที่บรรจุอยู่ในคาสเซ็ท (Cassette) แล้วแปลงเป็นข้อมูลในระบบดิจิทัลและส่งข้อมูลไปยังหน่วยความจำหรือเครื่องพิมพ์ภาพทางการแพทย์
- 3.2 มีค่าความละเอียดในการอ่าน (Acquisition) ไม่ต่ำกว่า 16 บิต/พิกเซล
- 3.3 ข้อมูลดิจิทัลที่ได้ต้องมีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 12 บิต (4,096 Gray scale)
- 3.4 สามารถวางคาสเซ็ทเพื่ออ่านได้ครั้งละ 1 แผ่น
- 3.5 สามารถอ่านคาสเซ็ทขนาด 14x17 นิ้ว ได้ไม่ต่ำกว่า 30 แผ่น/ชั่วโมง ที่ความละเอียดมาตรฐาน
- 3.6 ตัวเครื่องใช้เทคโนโลยีในการอ่านภาพเอกซเรย์เป็นแบบ Radius scan
- 3.7 ขนาดของเครื่องไม่มากกว่า 68x34x45 ซม, น้ำหนักไม่เกิน 25 กก. สามารถวางบนโต๊ะเพื่อความสะดวกในการทำงาน
- 3.8 ตัวเครื่องสามารถทำการติดตั้งให้สแกนได้ทั้งแนวตั้ง (Vertical Feed) และแนวนอน (Horizontal Feed) ได้
- 3.9 ความละเอียดของภาพขนาด 14x17 นิ้ว ที่ความละเอียดมาตรฐานสามารถอ่านได้ไม่น้อยกว่า 2180x2660 pixels และที่ความละเอียดสูงสามารถอ่านได้ไม่น้อยกว่า 4048x4932 pixels
- 3.10 มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 6 Pixel/mm. ในการอ่านภาพแบบความละเอียดมาตรฐานและ 12 Pixel/mm. ในการอ่านภาพแบบความละเอียดสูงเพื่อรายละเอียดของภาพที่ได้มีคุณภาพสูงช่วยในการวินิจฉัยโรคของแพทย์
- 3.11 มีคาสเซ็ทสำหรับบรรจุแผ่นบันทึกภาพเอกซเรย์ ดังนี้
 - 3.11.1 ขนาด 14x17 นิ้ว จำนวน 3 ชุด
 - 3.11.2 ขนาด 10x12 นิ้ว จำนวน 2 ชุด

4. ชุดคอมพิวเตอร์ควบคุม (Image Control) มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

- 4.1. เครื่องคอมพิวเตอร์มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิดประสิทธิภาพโดยรวมไม่ต่ำกว่า Core i5
- 4.2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ไม่น้อยกว่า 4 GB
- 4.3. มี Hard disk แบบ SATA สำหรับเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 500 GB
- 4.4. มี DVD-ROM Optical Drive
- 4.5. จอแสดงผลแบบ LED ความละเอียดสูงขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
- 4.6. มีเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA

(ลงมือ).....ผู้ซื้อ

(นายอัคราฐ ใจหาย)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายศรุตน์ หิรัญเขต)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เมดิคอล ดิจิตอล


(ลงมือ).....

(นายวิทยา ปิตโต)

5. เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณข้อมูลภาพเอ็กซเรย์ทันตกรรม จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

- 5.1 ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240 โวลท์ ความถี่ 50-60 เฮิร์ต
- 5.2 อ่านภาพจากแผ่นแปลงสัญญาณภาพ Imaging Plate (IP) ที่ผ่านการถ่ายภาพรังสีแล้ว สามารถแสดงภาพที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ได้
- 5.3 แผ่นแปลงสัญญาณภาพ (Imaging Plate) IP มีขนาดบางเทียบเท่ากับฟิล์ม ขอบสามารถโค้งงอ ได้ถึง 270 องศา สามารถใส่ในช่องปากได้สะดวก
- 5.4 ตัวเครื่องสามารถรองรับขนาดของแผ่นเพลท Size 0,1,2,3 ได้
- 5.5 ตัวเครื่องสามารถแยกขนาดแผ่นเพลทที่ใช้ในการสแกนได้อัตโนมัติ
- 5.6 ตัวเครื่องสามารถส่งแผ่นเพลทออกมาได้อัตโนมัติเมื่อสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- 5.7 ตัวเครื่องสามารถลบข้อมูลในแผ่นเพลททันทีเมื่อสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- 5.8 มีช่องใส่เปิด-ปิดแผ่น Imaging Plate (IP) ภายในตัวเครื่อง
- 5.9 การสแกนภาพมีการเคลื่อนที่ในแนวราบ ลดปัญหาเรื่องแผ่นตกภายในเครื่อง
- 5.10 ขนาดแผ่นแปลงสัญญาณภาพ Imaging plate (IP) มี 2 ขนาด ดังนี้
 - 5.10.1 ขนาด size 0 จำนวน 2 แผ่น
 - 5.10.2 ขนาด size 2 จำนวน 3 แผ่น
- 5.11 มีความชัด (Resolution) 20 Line pairs ต่อ มิลลิเมตร
- 5.12 ขนาดของ Pixel Size 25 ไมครอน
- 5.13 มีค่าระดับสีเทา (Grey Scale) 16 บิต
- 5.14 มีกระดาะป้องกันกัด (Bite Guard) Size 0 จำนวน 10 ชิ้น , Size 2 จำนวน 10 ชิ้น
- 5.15 ซองกันน้ำลาย (Hygienic Protective Sleeves) แบบใส่ครั้งเดียวทิ้ง สำหรับใส่ Imaging Plate
 - 5.15.1 Size 0 จำนวน 100 ซอง
 - 5.15.2 Size 2 จำนวน 500 ซอง
- 5.16 มีกล่องเก็บแผ่นเพลท จำนวน 1 กล่อง
- 5.17 ตัวเครื่องมีขนาดสูง 260 มิลลิเมตร กว้าง 167 มิลลิเมตร ยาว 325 มิลลิเมตร
- 5.18 โปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบ
 - 5.18.1 สามารถใช้กับระบบปฏิบัติการ windows ได้ (Operating system)
 - 5.18.2 มีระบบฐานข้อมูลสามารถป้อนข้อมูลเฉพาะของผู้ป่วยดังต่อไปนี้ เช่น ชื่อ-นามสกุล, วัน -เดือน-ปี ได้
 - 5.18.3 การค้นหาเพื่อเปิดแฟ้มข้อมูลของผู้ป่วยสามารถทำได้
 - 5.18.4 มีระบบปรับเพิ่มความคมชัดของภาพ
 - 5.18.5 มีระบบบรรทัดประโยชน์ช่วยในการวินิจฉัยภาพรังสี ดังต่อไปนี้
 - 5.18.5.1 สามารถวัดระยะระหว่างจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้
 - 5.18.5.2 สามารถวัดค่ามุมต่างๆได้

(ลงชื่อ)



ผู้ซื้อ

(นายอัคราทร จิตาพร)

(ลงชื่อ)



พยาน

(นายกรุตม์ ทิรัญโชติ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

เมดิคอล ดิจิตอล

(ลงชื่อ)



ผู้ขาย

(ลงชื่อ)



พยาน

(นายวิฑูรย์ ปิตโต)

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกสารอัตโนมัติจำนวน 1 ชุดมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

- 6.1 หน่วยประมวลผลกลาง ความเร็วไม่ต่ำกว่า Intel Core i5
- 6.2 มีหน่วยความจำแบบถาวร หรือ Hard disk drive ที่มีความจุไม่น้อยกว่า 1TB
- 6.3 มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ไม่น้อยกว่า 4 GB
- 6.4 มีระบบปฏิบัติการ Window 10 หรือดีกว่า
- 6.5 จอภาพชนิด LED ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
- 6.6 มีการ์ระบบเครือข่ายรองรับความเร็วในการเชื่อมต่อ 10/100/1000 Mbps
- 6.7 มี DVD RW
- 6.8 มีแป้นพิมพ์ (Key board) จำนวน 1 ชุด
- 6.9 มีเมาส์ (Mouse) จำนวน 1 ชุด
- 6.10 มีเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA

7. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับแสดงผลภาพเอกสารอัตโนมัติจำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

- 7.1 หน่วยประมวลผลกลาง ความเร็วไม่ต่ำกว่า Intel Core i3
- 7.2 มีหน่วยความจำแบบถาวร หรือ Hard disk drive ที่มีความจุไม่น้อยกว่า 1TB
- 7.3 มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ไม่น้อยกว่า 4 GB
- 7.4 มีระบบปฏิบัติการ Window 10 หรือดีกว่า
- 7.5 จอภาพชนิด LED ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
- 7.6 มีการ์ระบบเครือข่ายรองรับความเร็วในการเชื่อมต่อ 10/100/1000 Mbps
- 7.7 มี DVD RW
- 7.8 มีแป้นพิมพ์ (Key board) จำนวน 1 ชุด
- 7.9 มีเมาส์ (Mouse) จำนวน 1 ชุด
- 7.10 มีเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA

8. เงื่อนไขเฉพาะ

- 8.1 ผู้ให้เช่าจะต้องจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาติดตั้งและปรับแต่งเครื่องฯ จนสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
- 8.2 ผู้ให้เช่าจะต้องจัดส่งช่างผู้ชำนาญการมาตรวจเช็คและปรับแต่งเครื่อง CR ให้ตรงมาตรฐานของผู้ผลิตตลอดระยะเวลา 7 เดือน โดยไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้น
- 8.3 ผู้ให้เช่าต้องจัดให้มีบริการฉุกเฉินที่ให้บริการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และผู้ให้เช่าจะต้องส่งช่างเข้ามาภายใน 24 ชั่วโมง นับจากได้รับแจ้งจากผู้เช่าแล้ว
- 8.4 ผู้ให้เช่าต้องทำการฝึกอบรมแบบบรรยายให้กับแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำแผนกส่งตรวจต่างๆ
- 8.5 ผู้ให้เช่าต้องทำการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับรังสีแพทย์และนักรังสีการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานรังสี
- 8.6 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน 1 ชุด
- 8.7 ผู้ให้เช่าจัดทำการส่งภาพคนไข้ ส่งต่อเข้าจังหวัดให้ในระบบด้วย
- 8.8 รับประกันคุณภาพสินค้า ตลอดอายุการเช่า

ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายอิศรกร ใจหาญ)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นายศุภรัตน์ ทรัพย์เขต)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เมดิคอล เทคโนโลยี


(ลงชื่อ).....พยาน
(นายวิทยา บิตโต)

Carestream

Vita Flex CR System

TRANSFORM YOUR PRACTICE FROM FILM TO DIGITAL.

Make More Room for Care
in Your Clinical Facility.

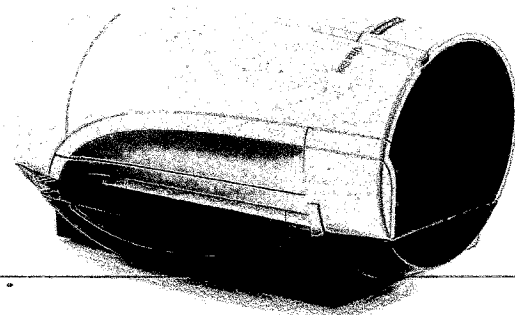


BIG PERFORMANCE FOR SMALLER FACILITIES.

If you're like many small practices or clinics, you know the tremendous value that in-house digital imaging can deliver.

But the high cost of entry for digital may be holding you back – not to mention the limited floor space you have for installation of such a system.


Meet the Vita Flex CR System – designed specifically for facilities like yours. It delivers high-quality digital images to speed workflow and improve patient care. Compact design makes it a great fit for smaller spaces. And, its affordable price tag makes it possible on nearly any budget.

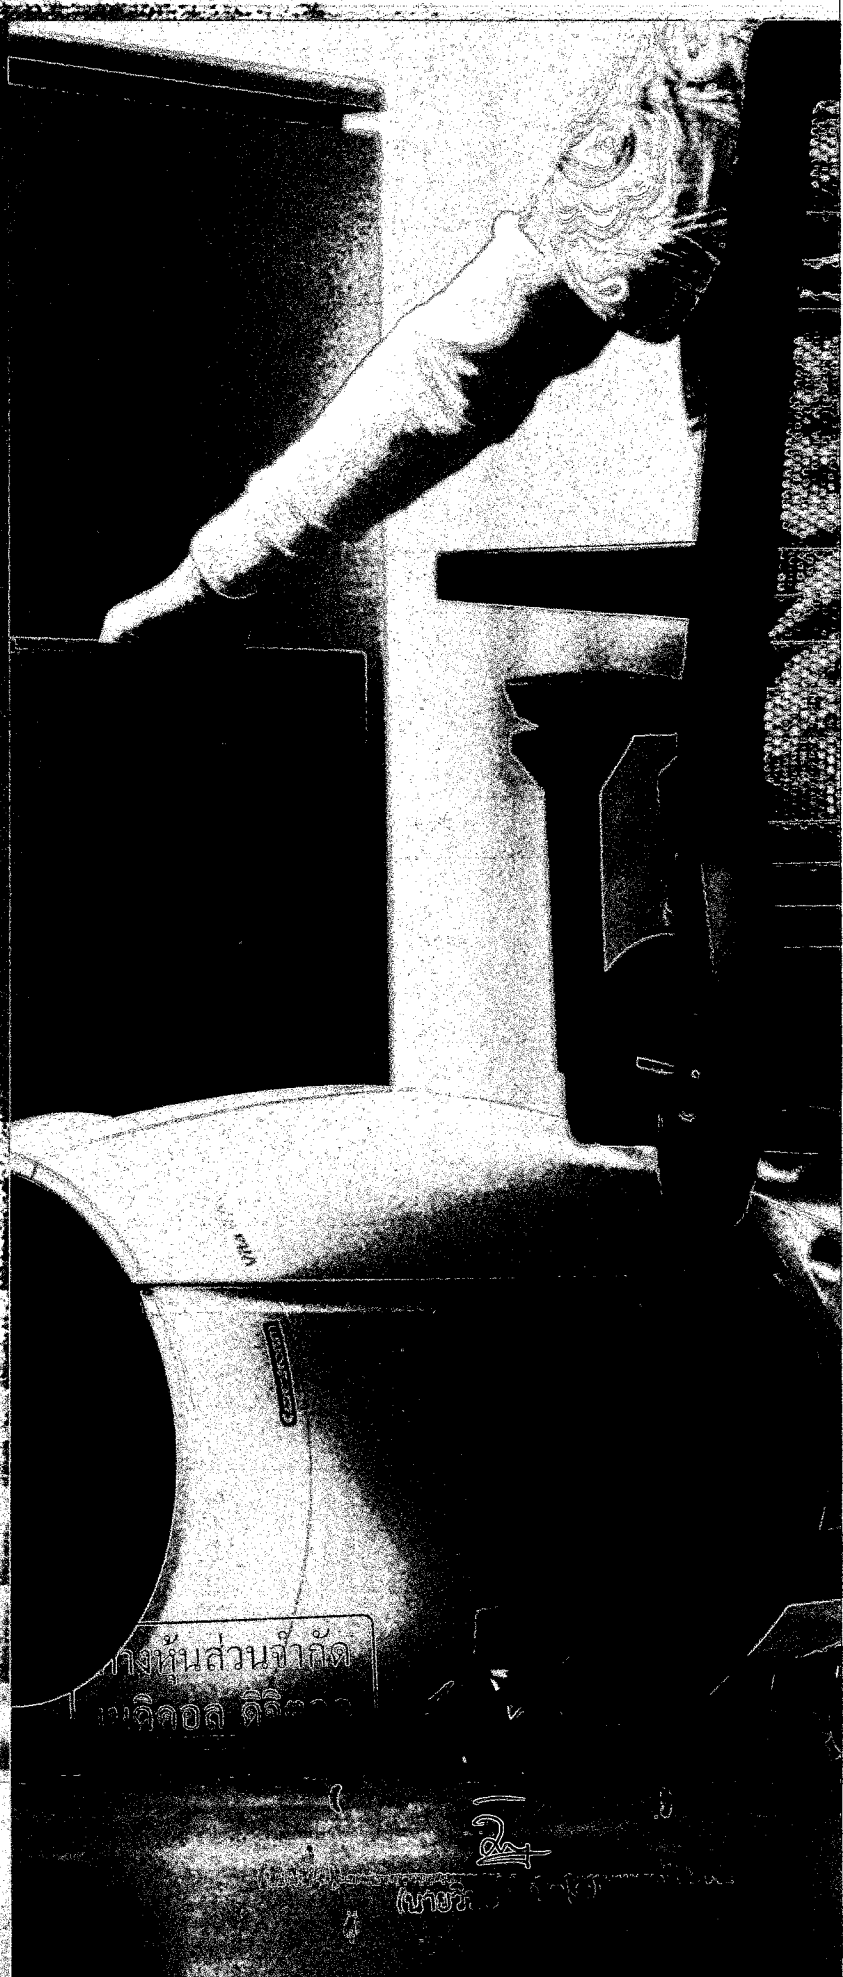

(ลงชื่อ).....**อรรถพร**.....ผู้ซื้อ
((นายอรรถพร ใจหาญ))
(ลงชื่อ).....**สมชาย**.....พยาน
((นายศรุตน์ ทิรัญโชติ))



ทางหุ้นส่วนจำกัด
เมทิลอด ดีลิคัต

(ลงชื่อ).....**สมชาย**.....
((นายสมชาย ใจหาญ))

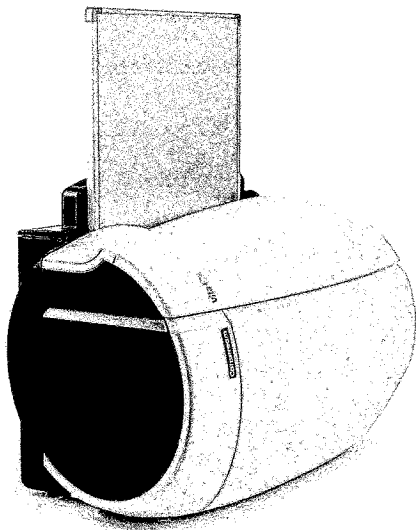

TWO WAYS TO SAVE SPACE – FlexFit

Vita Flex's benefits for small offices don't end with its compact footprint. You can find the fit that's best for you. Vita Flex fits on a tabletop, desktop, sitting on the floor or in the back of a van. You can position it in a traditional horizontal configuration, or set it up vertically if that's a better fit for your space. Now that's flexibility.

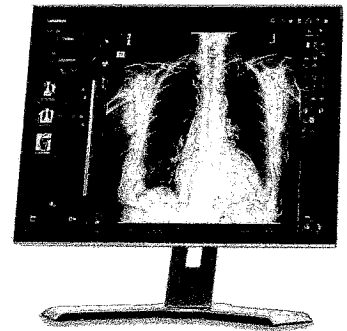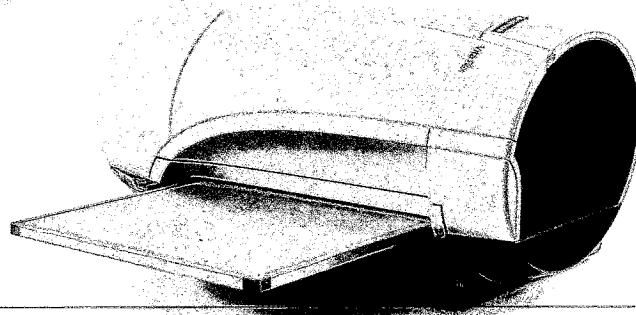

CUSTOM-DESIGNED WITH YOUR NEEDS IN MIND.

Why pay for capabilities you don't need and won't use? Large, complicated digital-imaging systems are overkill for your facility's needs. Vita Flex CR delivers precisely – and only – the capabilities you require. Just consider these advantages:

AFFORDABLE PURCHASE PRICE

- Go digital without breaking the bank

STREAMLINED OPERATIONS

- Say good-bye to ongoing purchase of consumables
- Forget the need to handle harsh chemicals
- No more for film to process

SMALL AND LIGHTWEIGHT

- Save valuable space with Vita Flex's compact footprint
- Configure vertically or horizontally to fit the tightest spaces
- Transport easily for mobile imaging

HIGH-QUALITY IMAGES


- Upgrade to superb digital images
- Enjoy easy-to-use Image Suite acquisition software
- Utilize powerful analysis tools in the software to improve diagnostics



SPEEDY PERFORMANCE


- View high-quality images in just minutes
- Choose your throughput rate (30 or 45 PPH)

EXPERIENCE THE VERSATILITY

- Select from multiple cassette sizes
- Handle all major exam types with confidence

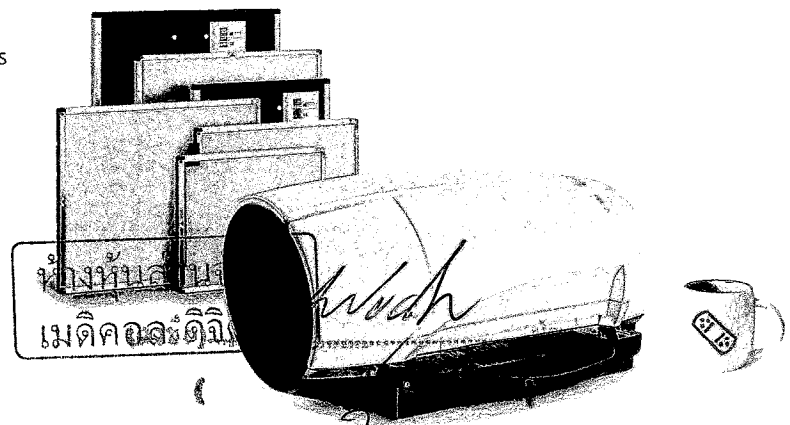

(นางสาว)  ผู้รื้อ
(นาย)  (นายชิตรากร ใจหาญ)
(นางสาว)  พยาบาล
(นาย)  (นายศรุตน์ ทิรัญโชติ)


(นางสาว)  พยาบาล
(นาย)  (นายวิทยา ปิตโต)

XRS

SMART X-RAY SOLUTIONS

NO MATTER WHICH ROAD YOU'RE ON,
WE'LL GET YOU WHERE
YOU NEED TO GO.

Carestream is ready to help you plan the most effective route to your X-ray imaging future. Let's plan out your equipment migration together – you'll gain the confidence that your current technology investment will continue to pay dividends well into your future.

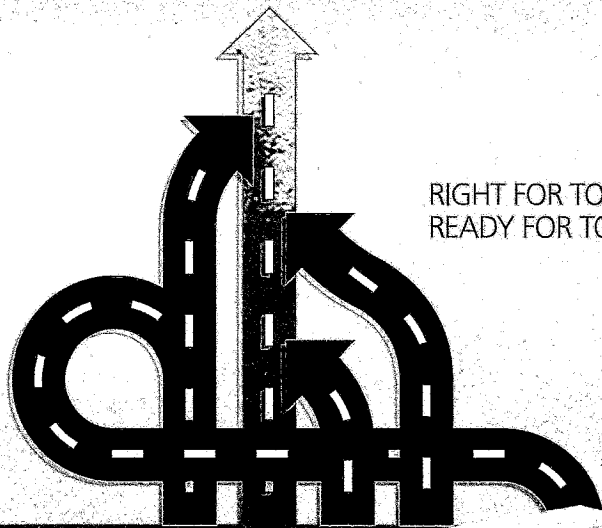

RIGHT FOR TODAY.
READY FOR TOMORROW.

SAVE TIME. SAVE MONEY.

Innovative Options for Installation and Service


Vita Flex introduces a progressive new approach to installation and service. Naturally, you can opt to have both handled by one of our expert technical-support people. But if you're even a little bit handy, you can handle these needs on your own – and in the process save yourself both hours and dollars. No tools or heavy technical expertise needed!

SELF-INSTALL OPTION

- Set up and start scanning immediately with easy self-install
- Go from carton to first image in less than 90 minutes.
- Or, choose full-service installation from a certified technician



SELF-SERVICE OPTION

- Fast self-repair maximizes uptime and budget
- Fix it yourself with three easy, field-replaceable units
- Or, call for full-service from a certified technician

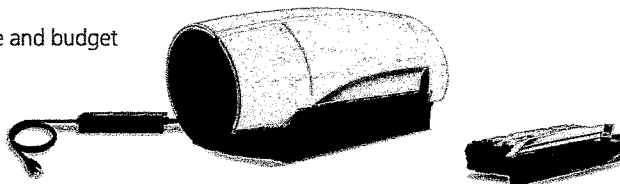

IDEAL FOR MOBILE APPLICATIONS

Need to take Vita Flex on the road? Its small size and light weight make it a breeze to transport and use in the field.

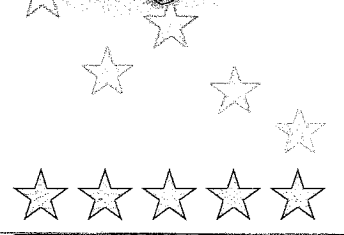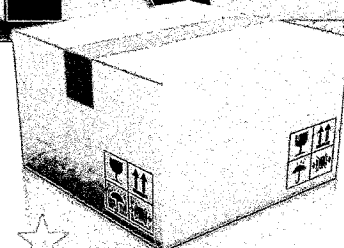

© Carestream Health, Inc., 2014. CARESTREAM and DIRECTVIEW are trademarks of Carestream Health, Inc. ZAT 200 0053 10/14

(นายอัครากร ใจหาญ)

(นางสาว) (นายศรุตม์ หิรัญโชติ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

เมตติคอล ดิจิตอล

carestream.com

Carestream

(นายวิทยา ปิตโต)

เครื่องสแกนภาพเอ็กซเรย์




มีติใหม่ แห่งการสแกนภาพเอ็กซเรย์ ด้วย...F200

ด้วยระบบ Optical scanner ให้ภาพที่คมชัด

ซอฟต์แวร์ใช้งานง่าย พร้อมใช้งานทันที

- เพลกสามารถใช้งานสูงสุดได้ถึง 2,000 ครั้งต่อแผ่น
- เพลกมีความหนาเพียง 0.1 มม. และสามารถดัดงอได้ถึง 270 องศา
- ออกแบบการเคลื่อนที่ของเพลกในแนวราบ
- รับประกันไม่มีปัญหาเรื่องแผ่นตกหรือติดในเครื่อง 100%
- ใช้ระบบแสงในการสแกนโดยปราศจากการสัมผัสเพลก

0 A2WLMU	1 A2WLMU	2 A2WLMU	3 A2WLMU
22 x 31 mm	24 x 40 mm	31 x 41 mm	27 x 54 mm

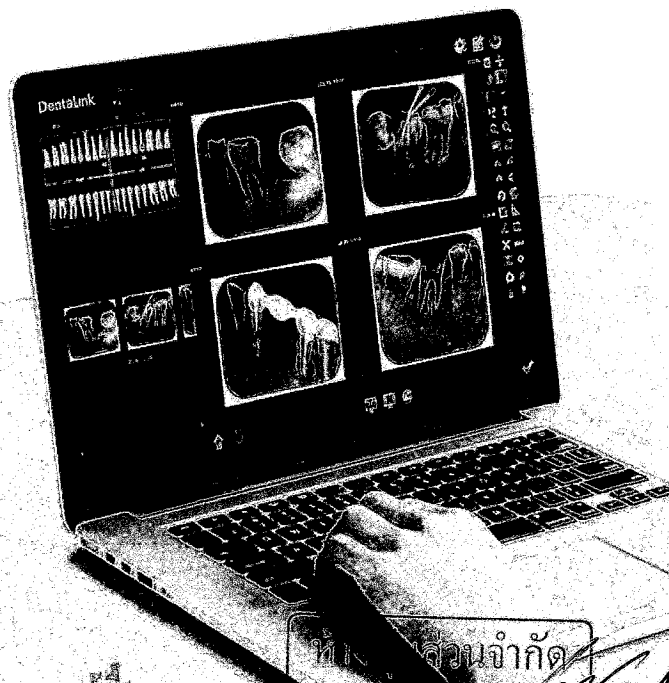

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายธรรณัฐ ใจหาญ)

ที่.....ส่วนจำกัด
.....นิติบุคคล

ผู้ขาย

(นายสุรนต์ ทรัพย์โชติ)

FUSSEN

(ลงชื่อ).....
(นาย.....)

Imaging Plate Scanner

Digitalized Intraoral Image Plate Scanning & Processing System

FUSSEN

Flexible Multifunctional Imaging Plate

- Maximizing product value: up to 2000 times for every piece of imaging Plate
- Thickness at 0.1mm & 270 degree bend

0	1	2	3
A2WLMU	A2WLMU	A2WLMU	A2WLMU
22 x 31 mm	24 x 40 mm	31 x 41 mm	27 x 54 mm

Imaging plate of 4 different sizes
#2 default, and other sizes optional



Smart sensing processing & High Definition X-Ray Image

- Smart sensing: security & lossless guaranteed by touching control tray for pushing in dental films
- Smart testing: auto-identifying size of dental film
- Smart scanning: auto-reading dental films plugged
- Smart erasing: auto clearing trace of dental film after reading
- Smart waiting: immediate use achieved by pushing-out after scanning
- Smart optimizing: auto-adjusting optimal contrast & brightness
- Smart energy-saving: auto-switch over energy-saving mode when a device stops using.

Model	Digitalized Intraoral Image Plate Scanning & Processing System F200
Supported Photophor Size	Size 0: 22×31 mm, Size 1: 24×40 mm, Size 2: 31×41 mm, Size3: 27×54 mm
Pixel Size	25 μm
USB Interface	USB 2.0, USB 3.0
Photophor Records	Automatic Clearing
Gray Scale	16 bit
Resolution	20 LP/MM
Power Supply	100-240 V(AC), 50/60 Hz, 1.5 A
Size (H*W*D)	260×167×325 mm
Weight	5.2 kg
Software	DICOM 3.0, Multi-frequency Image Processing System
Operating System	Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10

Data print & Output format

- Support DICOM and ordinary printers
- Data export with DICOM, DICOMDIR, BMP & JPG supportable.

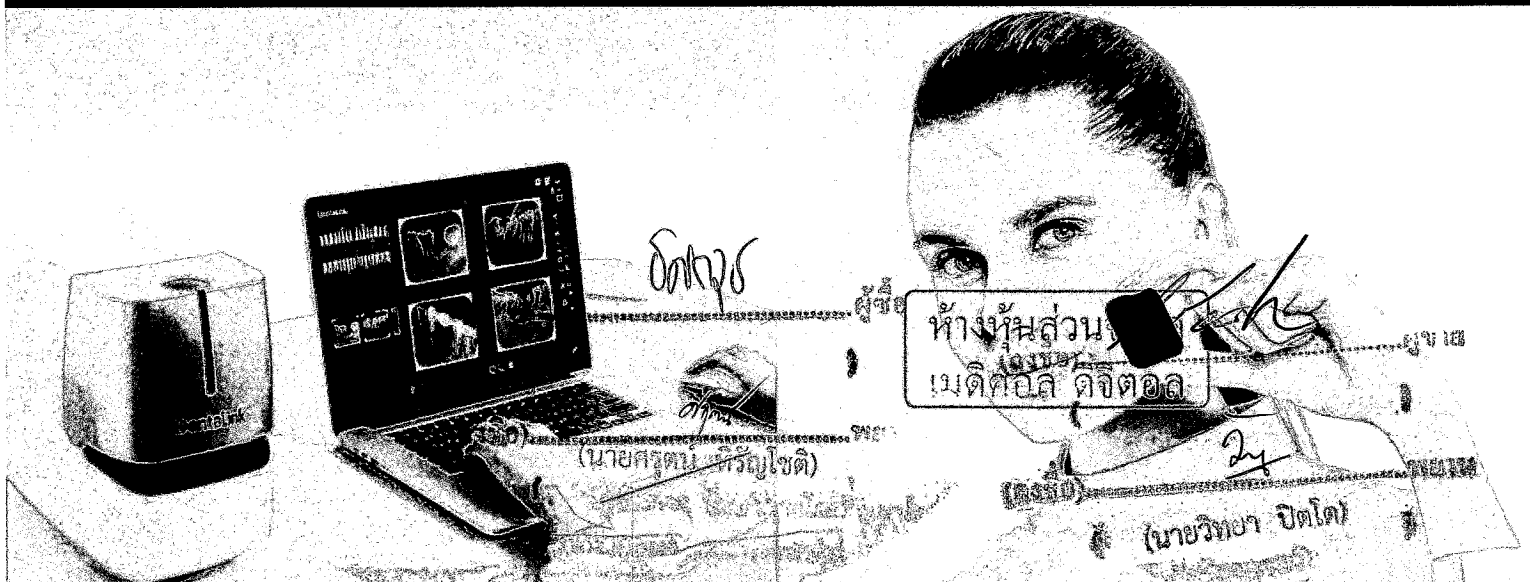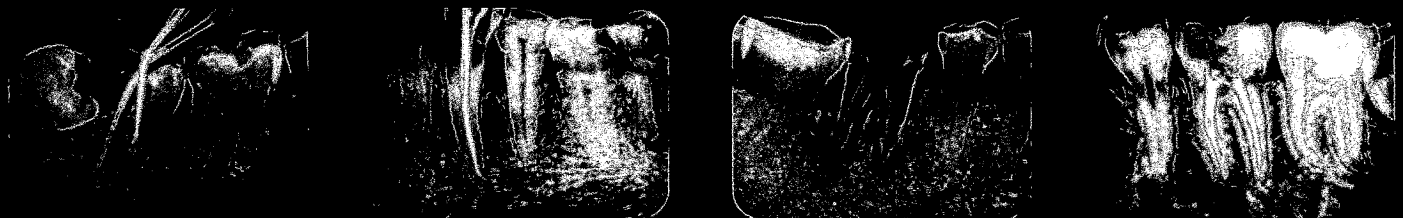

Distributed By: **SKYDENT** Skydent Co.,Ltd.


☎ 02-540-7295

f Skydent.co.th

🌐 www.skydent.co.th

GLM PACS SOLUTION

Easy & Comfort

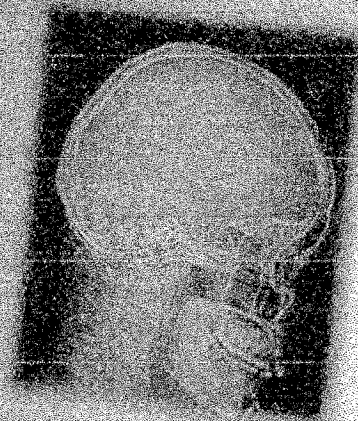

Bright & Clear


(นายอัคราฐ ใจหาญ)

(นายสุรตบ นริฏโชติ)

ทำสำเนาส่วนตัว
เมื่อก่อน
(นางสาว)

(นางสาว)


(นายวิทยา ปิตโต)

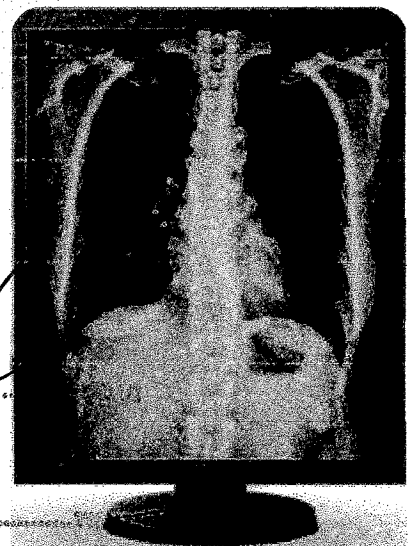



GLM PACS SOLUTION

Viewer Features

Image Support :	DICOM3, Jpeg ,BMP
Search Patient Filter :	Study Date ,Patient ID ,Patient Name , Modality Type
Security Control :	Username & Password
Image Processing Tools :	Zoom ,Magnify Glass ,Zoom Selected , Brightness ,Contrast , Negative ,Cine , Horizontal ,Vertical ,Left Rotate ,Right Rotate ,MPR , Multi Layout ,Presentation , Template Levels
Image Measurement :	Heart Measurement ,Ruler ,Ruler Width , Ruler Height ,Width Height ,Ploy Line , Angle ,Oval ,Square
Export Tools :	Print Paper ,Print Dry Film ,Print Log , Burn Image ,Save Jpeg ,Save DICOM , DICOM Send ,Send LINE
Report Tools :	Report Analysis , Print Report
Concurrent :	Unlimit Concurrent.
Minimum requirement :	Microsoft Windows XP,7,8,10 Processor 1 Ghz. RAM 512 MB. Hard disk Space 300 MB.

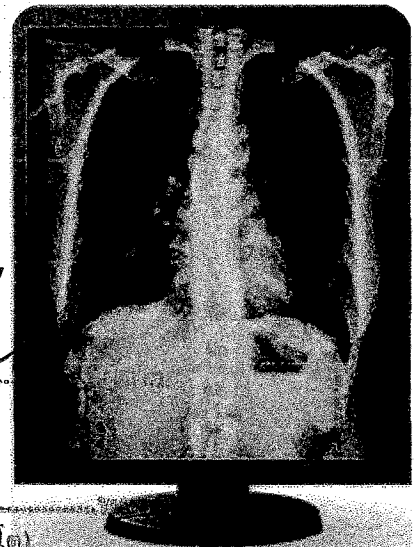

(นางสาว) 
(นาย) (นายอัครา ใจหาญ)
(นางสาว) 
(นาย) (นายสุวัฒน์ พิธีชัย)
(นางสาว) 


ห้างหุ้นส่วนจำกัด
(นางสาว) 
เมตคอลล ดิจิตอล

(นางสาว) 
(นายวิทยา ปิตโต)

GLM PACS SOLUTION

PACS Server Specification

DICOM Support :	DICOM3
DICOM Standard :	DICOM Store DICOM Modality Worklist DICOM Query / Retrieve DICOM Print DICOM Send
Language Support :	English , Thai
Modality Support :	DR, CR, CT, EKG,US,MG, MRI
Security Control :	User Authentication
Integration :	HL7,Data file, Database
System Platform :	Microsoft Windows
Application Platform :	Web base, Windows Application
PACS Admin Tools :	Security Command Control Storage Status Log System Backup Data Module

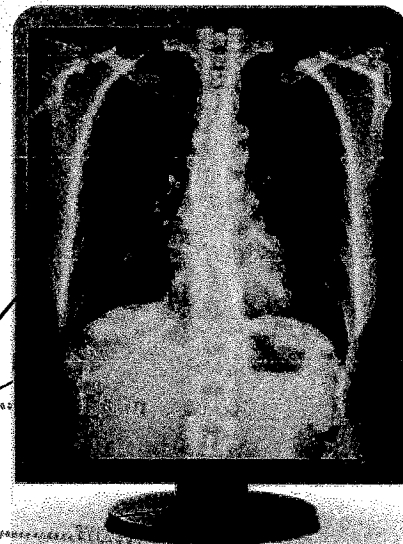

(ลงชื่อ).....

(นายอรรษ ใจหาญ)

(ลงชื่อ).....

(นายสุวัฒน์ ทรัพย์โชติ)

ทำขึ้นส่วนจัด
เมตคูล ดิจิตอล

(ลงชื่อ).....

(นายวิทยา ปิตโต)




1. เครื่องแม่ข่ายระบบจัดเก็บภาพ(PACS SERVER) จำนวน 1 เครื่อง

1.1. CPU Intel Xeon E-2124 (3.3GHz/4-core/8MB/71W) Processor

1.2. RAM 8GB (1x8GB UDIMMs, 2666 MT/s)

1.3. HDD. SATA 2TBx2 Raid 1

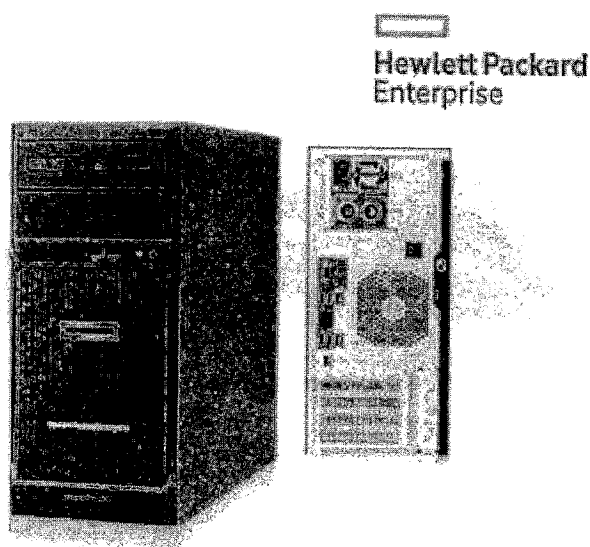

HPE ProLiant ML30 Gen10 Standard SET

HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2124 3.3GHz 4-core 1P 8GB-U
S100i 4LFF NHP 350W PS Entry Server

Specification

Intel Xeon E-2124 (3.3GHz/4-core/8MB/71W) Processor

8GB (1x8GB UDIMMs, 2666 MT/s)

Embedded 2-Port 1GbE HPE Ethernet 332i Adapter

Embedded S100i SW RAID with 4 SATA ports

4 LFF HDD Bays (Non Hot Plug), 1x M.2 PCIe 3.0 x2 slot

350W ATX Power Supply

iLO Management (standard), Intelligent Provisioning
(standard)

HPE 3Y Next Business Day, On-site Support

(ลงชื่อ).....
(นายอัคราช ใจหาญ) ผู้ซื้อ

(นายอัคราช ใจหาญ)

(ลงชื่อ).....
(นายศรุตน์ หิรัญโชติ) พยาน

(นายศรุตน์ หิรัญโชติ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เมดิคอล ดิจิตอล

(ลงชื่อ).....
(นายวิทยา ปิตโต) ผู้ขาย

(ลงชื่อ).....
(นายวิทยา ปิตโต) พยาน

(นายวิทยา ปิตโต)




2. เครื่องลูกข่ายแสดงผลภาพเอกซเรย์ จำนวน 4 เครื่อง

Technical Specifications

APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V | BR900GI | Downloaded on 03/27/2019 (EST)

Life Is On **APC**
Schneider Electric

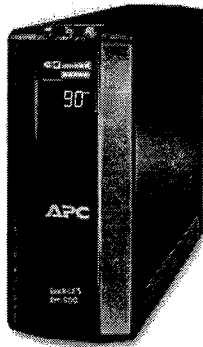

APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V BR900GI

Call for More Information +1-5000-55

- High Performance Computer and Electronics UPS for Premium Power Protection
- Includes: CD with software, Qty 1- Detachable IEC Power Cord, USB cable, User Manual, Warranty card

Output

Output power capacity	540Watts / 900VA
Max Configurable Power (Watts)	540Watts / 900VA
Nominal Output Voltage	230V
Output Frequency (sync to mains)	50/60Hz +/- 3 Hz
Output Frequency (not synced)	50/60 Hz +/-1 Hz
Load Crest Factor	3 : 1
Topology	Line Interactive
Waveform type	Stepped approximation to a sine wave
Output Connections	(4) IEC 320 C13 (selector_surgetitle) (2) IEC Jumpers (Battery Backup) (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Transfer Time	8ms typical : 10 ms maximum
Bypass	Built-in Bypass

Input

Nominal Input Voltage	230V
Input frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
Input Connections	IEC-320 C14
Input voltage range for main operations	176 - 294V
Input voltage adjustable range for mains operation	156 - 300V
Number of Power Cords	1
Maximum Input Current	8.0A

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.

Product link: <https://www.apc.com/shop/id/en/products/APC-Power-Saving-Back-UPS-Pro-900-230V/P-BR900GI>

APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V | BR900GI | Downloaded on 03/27/2019 (EST)

Life Is On



Batteries & Runtime	
Battery type	Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof
Typical recharge time	8hour(s)
Replacement Battery	APCRBC123
Expected Battery Life (years)	3 - 5
RBC Quantity	1
Runtime	View Runtime Graph (Available in Technical Tab on site) View Runtime Chart (Available in Technical Tab on site)
Efficiency	View Efficiency Graph (Available in Technical Tab on site)

Communications & Management	
Interface Port(s)	Optional Simple Signalling RS232 cable, USB
Control panel	Multi-function LCD status and control console
Audible Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Surge Protection and Filtering	
Surge energy rating	613Joules
Data Line Protection	Analog phone line for phone/fax/modem/DSL (RJ-11 connector), Network line - 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45 connector)
Filtering	Full time multi-pole noise filtering :10% of IEEE surge let-thgouh : zero clamping response time: instantaneous

Physical	
Maximum Height	250MM, 25.0CM
Maximum Width	100MM, 10.0CM
Maximum Depth	382MM, 38.2CM
Net Weight	10.72KG
Shipping weight	11.7KG
Shipping Height	337MM, 33.7CM
Shipping Width	225MM, 22.5CM
Shipping Depth	487MM, 48.7CM
Color	Black
Master Carton Units	

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.

Technical Specifications

APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V | BR900GI | Downloaded on 03/27/2019 (EST)

Life Is On APC
by Schneider Electric

Physical	
Pallet Dimensions	46inches
Pallet Weight	865.22lbs.
Units per Pallet	30.0
SCC Codes	1073130427959 1

Environmental	
Operating Temperature	0 - 40 °C
Operating Relative Humidity	0 - 95 %
Operating Elevation	0-2952.6meters
Storage Temperature	-15 - 45 °C
Storage Relative Humidity	0 - 95 %
Storage Elevation	0-14763.6meters
Audible noise at 1 meter from surface of unit	45.0dBA

Conformance	
Approvals	A-tick, C-tick, CE, GS Mark
Equipment protection policy	Lifetime : 200000 AUD, Lifetime : 150000 Euros, Lifetime : 75000 GBP
Standard warranty	2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries

Sustainable Offer Status	
RoHS	Compliant
REACH	REACH: Contains No SVHCs
PEP	Available in Documentation tab
EOL	Available in Documentation tab

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
 (นายอัครกฤษ ใจหาญ)
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (นายศรุตน์ หิรัญโชติ)
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 เมคคอลล ดิจิตอล
 (ลงชื่อ).....ผู้ขาย
 (นายวิทยา ปิตโต)

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.

LENOVO D22-10

DISPLAY THAT DRIVES IMAGINATION



ECONOMICAL MONITOR FOR EVERYDAY USE

This 21.5-inch full-HD monitor provides a smooth viewing experience along with a good value for money. Its 5ms response time reduces motion blur and unwanted ghosting and tearing. The TÜV Low Blue Light certification ensures reduced blue light emission from the screen, protecting your eyes from its harmful effects. The VGA and HDMI ports provide connectivity options so that you can plug into your gaming consoles, laptops, or PCs, and enjoy smooth streaming.


The Quick Release Tilt Stand lets you adjust the monitor for your viewing comfort while the VESA wall-mount allows you to fix it onto the wall for better visibility and reduced desk clutter.

FEATURES OF LENOVO D22-10




View Things Better and Clearer

The Lenovo D22-10 monitor offers rich visual details on a 21.5-inch display. The full-HD, 1920 x 1080 resolution screen allows you to experience vivid images and videos with better clarity.

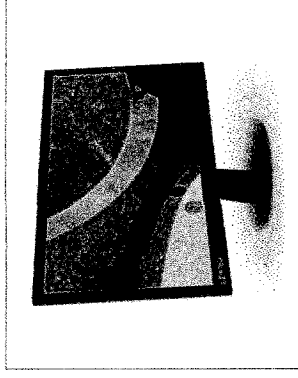


Position It as You Like

With the Quick Release Tilt Stand you can easily adjust your display for comfortable viewing. The 100mm VESA wall-mount allows you to fix the monitor on the wall, leaving you with more desk space.

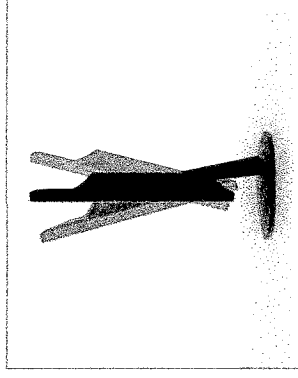


Protect Your Eyesight

The flicker-free display of the Lenovo D22-10 is TÜV Low Blue Light certified that ensures your eyes are protected from the harmful effects of the blue light emissions from the screen.

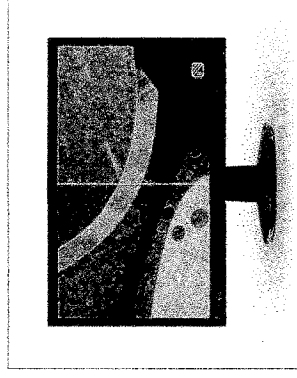

Lenovo

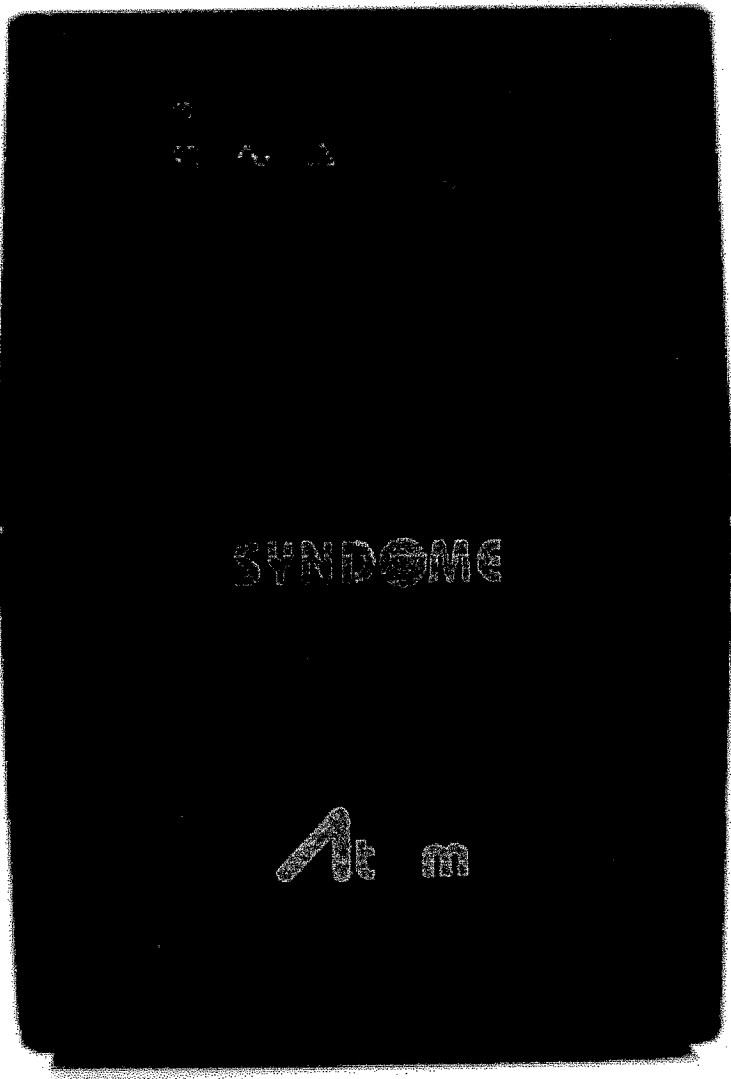

(ลงชื่อ).....
(นายอัคราฐ ใจหาญ)
(ลงชื่อ).....
(นายศรุตน์ หิรัญโชติ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เมตริกอสติคิตอส
(ลงชื่อ).....
(นายวิฑา ปิตโต)

ที่ 100922208745



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0133561001601

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

- ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดिकอล ดิจิตอล
- ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายเกรียงไกร จิตะสังจา

ลงทุนด้วย เงิน

จำนวน

450,000.00 บาท

2. นางสาวสุจิตรา เสวกพันธ์

ลงทุนด้วย เงิน

จำนวน

50,000.00 บาท

- หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายเกรียงไกร จิตะสังจา/

- ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี

- สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 71/49 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี/

- วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 23 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมี
ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

(นางมนฤดี แสงพลอย)

นายทะเบียน

(ลงชื่อ).....

(นายธีรกร ใจหาญ)

(ลงชื่อ).....

(นายเศรษฐ์ ธีรโชติ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เมดิกอล ดิจิตอล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เมดิกอล ดิจิตอล

(ลงชื่อ).....

(นายวิทยา ปิตโต)

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่การเป็น Leading Business
Transformation





ที่ 100922208745

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 100922208745

- นิติบุคคลนี้ขาดส่งงบการเงินปี 2562
- หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....

(นายธีรารุช ใจหาญ)

(ลงชื่อ).....

(นายศุภรัตน์ หิรัญโชติ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

เมดิคอล ดิจิตอล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

เมดิคอล ดิจิตอล

(ลงชื่อ).....

(นายวิทยา ปิตโต)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ

Leading Business

Towards Greater

Transformation



2.1 (วพ.)

รายละเอียดวัตถุประสงค์

24

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เข้า เข้าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือโดยวิธีอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบพาณิชย์กรรม

- (7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
- (8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง บาล์ม น้ำมัน ปอ ผ้ายัน พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครึ่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด
- (9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หม่อนไหม พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายย้อมยัด เส้นใยลอน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา
- (11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี่ เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ
- (14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- (15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือทางการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ ยาปราบศัตรูพืช ยาสมุนไพรและสัตว์ทุกชนิด

- (16) ประกอบกิจการค้า เครื่องเล่น เครื่องดนตรี และเครื่องใช้เสริมความงาม
- (17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพ และภาพยนตร์ เครื่องเล่นดนตรี เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน

(นายสุรนต์ ธีรวิชัย)

(นายวิฑูรย์ บิตโต)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เมตคอลลิจิตอล

เมตคอลลิจิตอล



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
Leading Business
Towards Digital
Transformation



เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

- (18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
- (19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป
- (20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (21) สิ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์
- (22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เมติคอล ดิจิตอล

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(นายอภิรักษ์ ใจหาญ)

(ลงชื่อ) ผู้ขาย

(นายสุรตน์ ทิรัญโชติ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เมติคอล ดิจิตอล

(ลงชื่อ) ผู้ขาย

(นายวิทยา ปิตโต)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่เป้าหมาย
สู่ความสำเร็จ

Leading Business
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 23 ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าซื้อเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์และเครื่องจักรทุกประเภท

รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

(ลงชื่อ).....

(นายธีรราช ใจหาญ)

(ลงชื่อ).....

(นายสรุจน์ หิรัญโชติ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

เมติคอล ดิจิตอล


(ลงชื่อ).....

(นายวิทยา ปิตโต)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เมติคอล ดิจิตอลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerceก้าวล้ำธุรกิจ
Leading BusinessBeyond Dream
Transformation

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม



เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
0-1335-61001-60-1

ชื่อผู้ประกอบการ ทางส่วนจำกัด เมติคอส ดีไซน์

ชื่อสถานประกอบการ เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่ อาคาร ห้องเลขที่

หมู่บ้าน เลขที่ 71/49

หมู่ที่ 3 ต.รอก/ซอย ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต คลองหลวง

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 12120 โทรศัพท์

วันที่ทะเบียนผู้ประกอบการจดทะเบียน 8 เมษายน 2561

ออกให้เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๑

ผู้ออกทะเบียน (นางดวงใจ ดะสน์เทษะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่บางนา-ตราด ๒

นางสาวส่วนจำกัด
เมติคอส ดีไซน์

(นายวิทยา บัดโต)

(นายสุรตน์ หิรัญโชติ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

เป็นรายสถานประกอบการ ให้ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการ และจดทะเบียนผู้ประกอบการไว้ด้วย และต้องแสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยซึ่งไม่ใช่ว่าเป็นสถานประกอบการ

คำเตือน

ทะเบียนเลขที่ 0133561001601



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมติคอล ดิจิตอล

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

ออกให้ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

(นายบุญช่วย เถียรธีรภาพ)

นายทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เมติคอล ดิจิตอล

(ลงชื่อ).....

(นายธีรารักษ์ ใจหาญ)

(ลงชื่อ).....

(นายศรุตน์ หิรัญโชติ)

(ลงชื่อ).....

(นายวิฑา ปิตโต)

e-GP 03-0102		วันที่แจ้งลงทะเบียน 10/05/2561																	
แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP		วันที่อนุมัติ 11/05/2561																	
ลำดับการลงทะเบียน M-2561-023662		วันที่เริ่มใช้งาน 11/05/2561																	
สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ																			
1.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(0133561001601) ประเภทผู้ประกอบการ นิติบุคคล 2.ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมดิคอล ดิจิตอล ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) MEDICAL DIGITAL LIMITED PARTNERSHIP 3.ที่ตั้งสำนักงาน : อาคาร ชั้นที่ หมู่บ้าน เลขที่ 71/49 หมู่ที่ 3 ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง คลองหนึ่ง อำเภอ/เขต คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120 โทรศัพท์ 0847328118 อีเมล ting_krieng@hotmail.com																			
4.กรณีบุคคลธรรมดา (เลขประจำตัวประชาชน -) วัน/เดือน/ปีเกิด สัญชาติ ไทย 5.กรณีนิติบุคคล ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 01335561001601 วันเดือนปีที่จดทะเบียน 04/04/2561 จดทะเบียนที่ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดปทุมธานี ทุน (1) เงินทุนจดทะเบียน 500000.00 (บาท) (2) ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 500000.00 (บาท)		6.ประเภทของการประกอบกิจการ <table border="1"> <thead> <tr> <th>ประเภทกิจการ</th> <th>ประเภทสินค้าและหรือบริการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐ ผลิต</td> <td>☒ วัสดุครุภัณฑ์</td> </tr> <tr> <td>☐ ส่งออก</td> <td>☐ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</td> </tr> <tr> <td>☒ ขายส่ง</td> <td>☐ จ้างก่อสร้าง</td> </tr> <tr> <td>☒ ขายปลีก</td> <td>☐ จ้างเหมา</td> </tr> <tr> <td>☒ ให้บริการ</td> <td>☒ เช่า</td> </tr> <tr> <td></td> <td>☐ จ้างที่ปรึกษา</td> </tr> <tr> <td></td> <td>☐ จ้างออกแบบและควบคุม</td> </tr> </tbody> </table>		ประเภทกิจการ	ประเภทสินค้าและหรือบริการ	☐ ผลิต	☒ วัสดุครุภัณฑ์	☐ ส่งออก	☐ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	☒ ขายส่ง	☐ จ้างก่อสร้าง	☒ ขายปลีก	☐ จ้างเหมา	☒ ให้บริการ	☒ เช่า		☐ จ้างที่ปรึกษา		☐ จ้างออกแบบและควบคุม
ประเภทกิจการ	ประเภทสินค้าและหรือบริการ																		
☐ ผลิต	☒ วัสดุครุภัณฑ์																		
☐ ส่งออก	☐ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																		
☒ ขายส่ง	☐ จ้างก่อสร้าง																		
☒ ขายปลีก	☐ จ้างเหมา																		
☒ ให้บริการ	☒ เช่า																		
	☐ จ้างที่ปรึกษา																		
	☐ จ้างออกแบบและควบคุม																		
☒ กรณีผู้ลงทะเบียนลงข้อมูลหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะถูกลบชื่อเป็นผู้ใช้งาน ☒ กรณีผู้ลงทะเบียนกระทำการใดๆอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ลงทะเบียนจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว																			
หมายเหตุ : แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สามารถนำไปยื่นพร้อมเอกสารการเสนอราคา กับหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชี รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมที่กำหนดให้ผู้ที่จะเข้าเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐที่สัญญามีมูลค่าตามจำนวนเงินดังกล่าวต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP																			
พิมพ์เมื่อวันที่ 11/05/2561 เวลา 23:22:25 น. รหัส PHFYD																			

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(นายยศราวุธ ใจหาย)

(ลงชื่อ) ผู้ขาย

(นายศุภรณ์ หิรัญโชติ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

เมดิคอลดิจิตอล

(ลงชื่อ)

(นายวิฑูรย์ ปิตโต)


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number **3 1302 00029 14 6**
 ชื่อตัวและชื่อสกุล **นาย เกรียงไกร จิตะสังข์**
 Name **Mr. Kriengkrai**
 Last name **Thitsasangka**
 เกิดวันที่ **18 ต.ค. 2512**
 Date of Birth **18 Oct. 1969**
 ศาสนา **พุทธ**
 ที่อยู่ **690/5 ถ.พระยาสุรเสนา แขวงบางขุน**
 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
 27 ก.ย. 2559
 วันออกบัตร
 27 Sep. 2016
 Date of Issue
 17 ต.ค. 2567
 วันบัตรหมดอายุ
 17 Oct. 2024
 Date of Expiry
1046-00-09271349

(ลงชื่อ)

(นายธีรยุทธ ใจหาญ)

(ลงชื่อ)

(นายศรุตน์ ทิรัณโศติ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 เมทีลเม็ค, ดีจิตอล

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา ปิตโต)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิคอล ดิจิตอล MEDICAL DIGITAL LTD., PART.

71/49 หมู่ที่ 3 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร 084-7328118, 086-4684525

ใบเสนอราคา

เลขที่ : 001/63

วันที่ : 120 ก.พ. 2563

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศรีสมเด็จ

อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิคอล ดิจิตอล ขอเสนอราคาสินค้า ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน(เดือน)	เดือนละ	จำนวนเงิน
1	ค่าเช่า เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล CR พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลภาพทางการแพทย์ Pacs และเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัลของทันตกรรม	7	35,000.00	245,000.00
สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน		ราคาสินค้า		228,971.96
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		16,028.04
		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น		245,000.00

กำหนดขึ้นราคา 60 วัน กำหนดส่งของ/ติดตั้ง 120 วัน

อนุมัติจัดซื้อ

ลงชื่อ.....

(ลงชื่อ).....

(นายอัคราภ ใจหาญ)

(ลงชื่อ).....

(นายศรุตน์ หิรัญโชติ)

ขอแสดงความนับถือ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิคอล ดิจิตอล (บริษัท เมดิคอล ดิจิตอล จำกัด)

เมดิคอล ดิจิตอล

พนักงานขาย.....

(ลงชื่อ).....

(นายวิภา ปิตโต)



เลขที่ รอ. 2236

เลขที่ 81

ใบเสร็จรับเงิน

ในรายการ

รพ. ศิริราช

สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

วันที่

26

เดือน

มิถุนายน

ปี 2563

ได้รับเงินจาก

ทศก. เมาส์ดอยด์ อัจฉริยะ

ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	
	จำนวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน	เปิดได้
ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจ คิววีเคาะหิโรค		
ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ		
ค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ		
ค่าตรวจทางรังสีวิทยา		
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ		
ค่าห้อง		
ค่าอาหาร		
ค่าธรรมเนียมบัตรทอง 30 บาท		
ค่าใบรับรองแพทย์		
ค่าบริการทันตกรรม		
อื่นๆ - โฉมฟรี - งานศพ ฯลฯ	12,200	
รวมทั้งเงินจาก/จัดสรรในแพทย์		
(รวมรวม PRCG) สสจ.ภูเก็ต 1/12/63		
รวมเงิน	12,200	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,200	

(ตัวอักษร)

นายแพทย์ศิริราช

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงาน